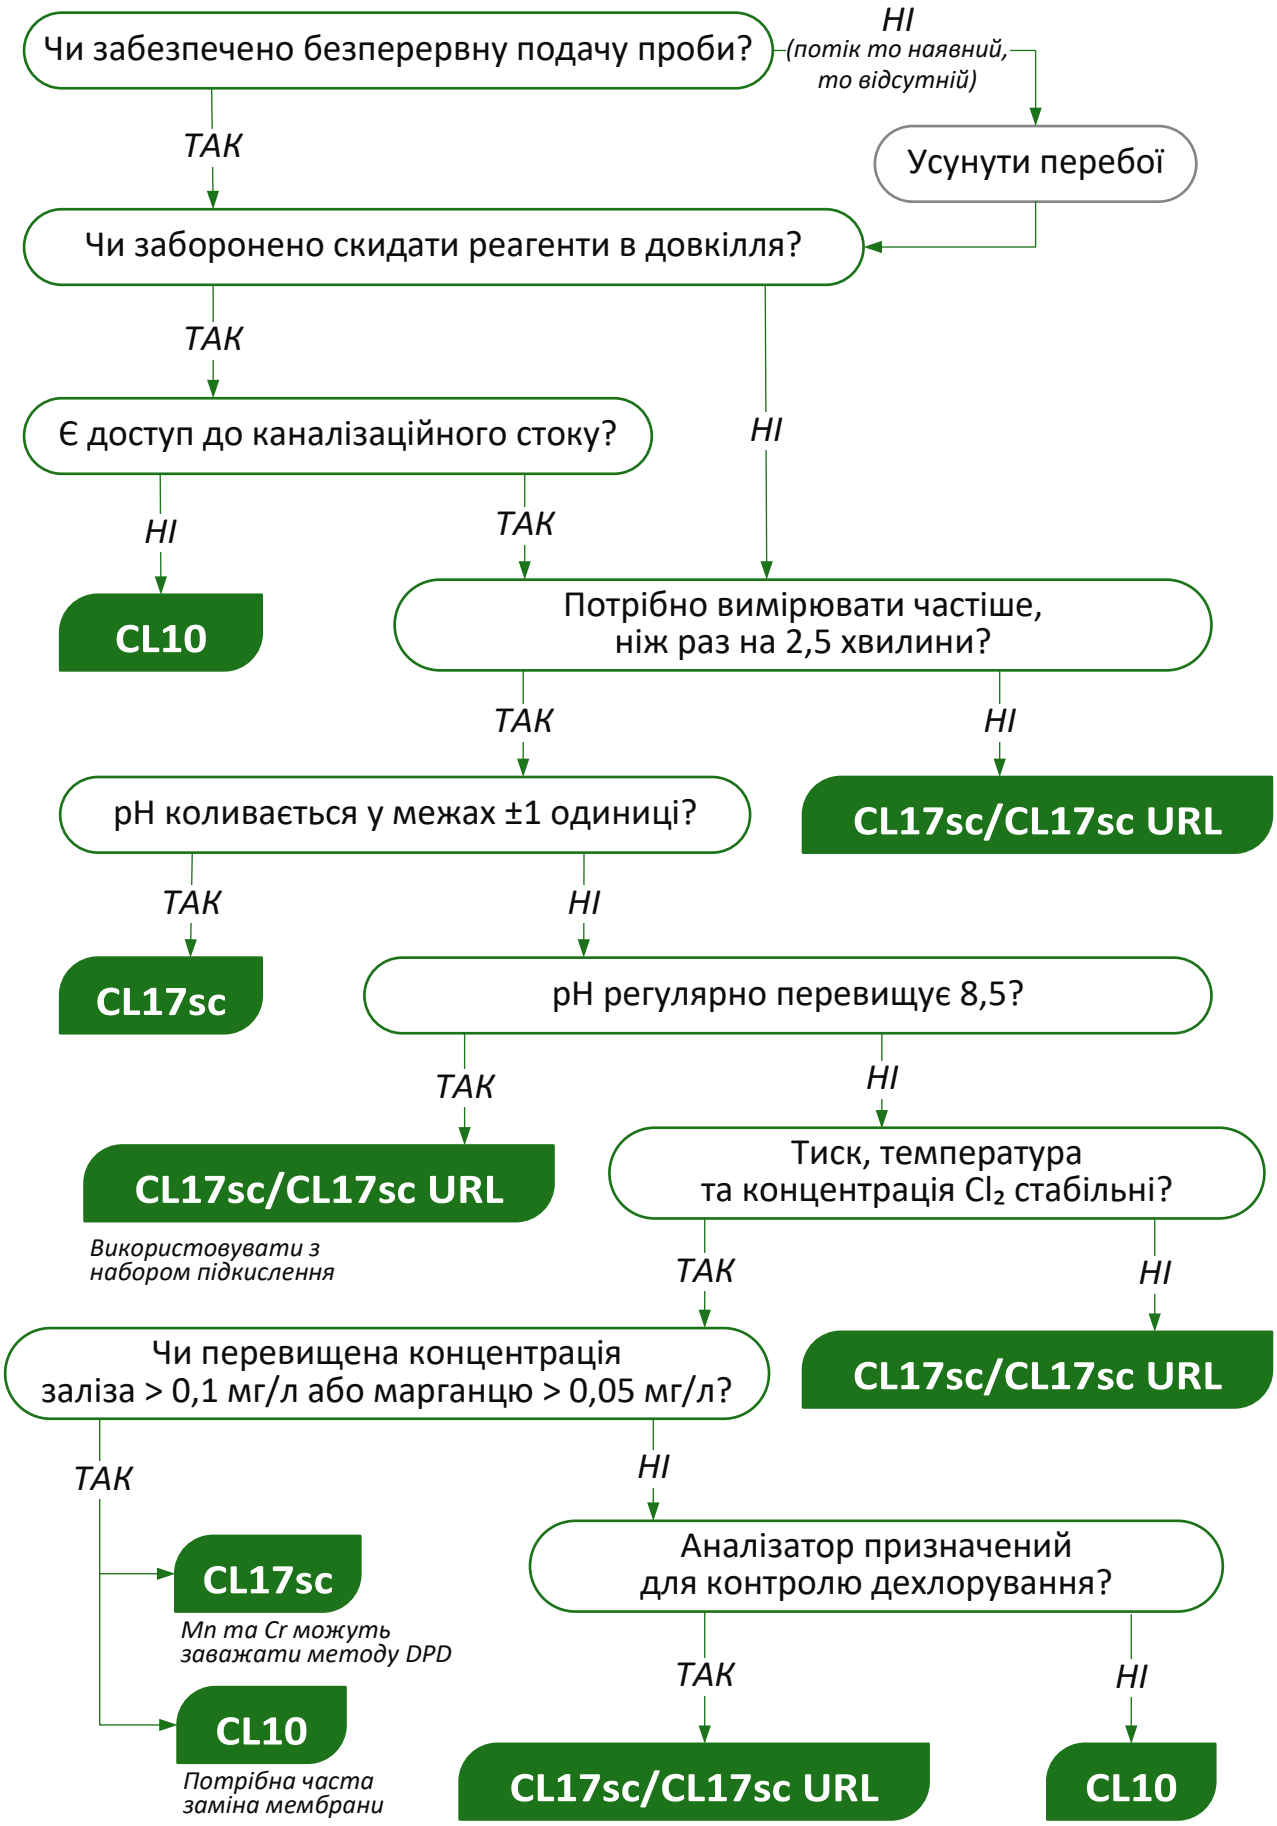
Чи забезпечено безперервну подачу проби?
НІ
(потік то наявний, то відсутній)
Усунути перебої
ТАК
Чи заборонено скидати реагенти в довкілля?
ТАК
НІ
Є доступ до каналізаційного стоку?
НІ
ТАК
CL10
Потрібно вимірювати частіше, ніж раз на 2,5 хвилини?
ТАК
НІ
CL17sc/CL17sc URL
pH коливається у межах ±1 одиниці?
ТАК
НІ
CL17sc
pH регулярно перевищує 8,5?
ТАК
НІ
CL17sc/CL17sc URL
Використовувати з набором підкислення
Тиск, температура та концентрація Cl_2 стабільні?
ТАК
НІ
CL17sc/CL17sc URL
Чи перевищена концентрація заліза > 0,1 мг/л або марганцю > 0,05 мг/л?
ТАК
НІ
CL17sc
Mn та Cr можуть заважати методу DPD
CL10
Потрібна часта заміна мембрани
Аналізатор призначений для контролю дехлорування?
ТАК
НІ
CL17sc/CL17sc URL
CL10